



200

Silikonkattega lantsetid
Silikonu dengti lantsetai
Ar silikonu pārkārtātas lantsetes
Silikonhübsär blöðhnifrar

AVAMISEKS TĪMBA ALLA. • PATRAUKITE, KAD
ATIDARYTUMĖTE. • PAVELCIET UZ LEJŪ, LAI
ATVERTU. • DRAGIO NIDUR TIL AD OPNA.



- IT** • Kasutada koos seerifa Microlet® lantsetisaadmetega.
- LT** • Naudoti su „Microlet®“ grupės prietaisais.
- LV** • Lietojiet kopā ar Microlet® zaimes lantsetes ierīcēm.
- S** • Notiti með Microlet® stungupennum.

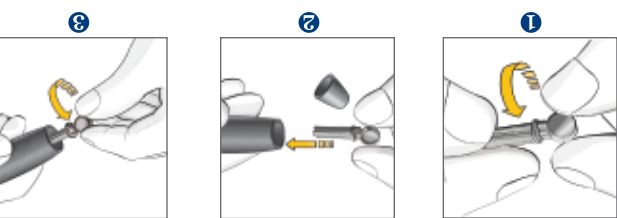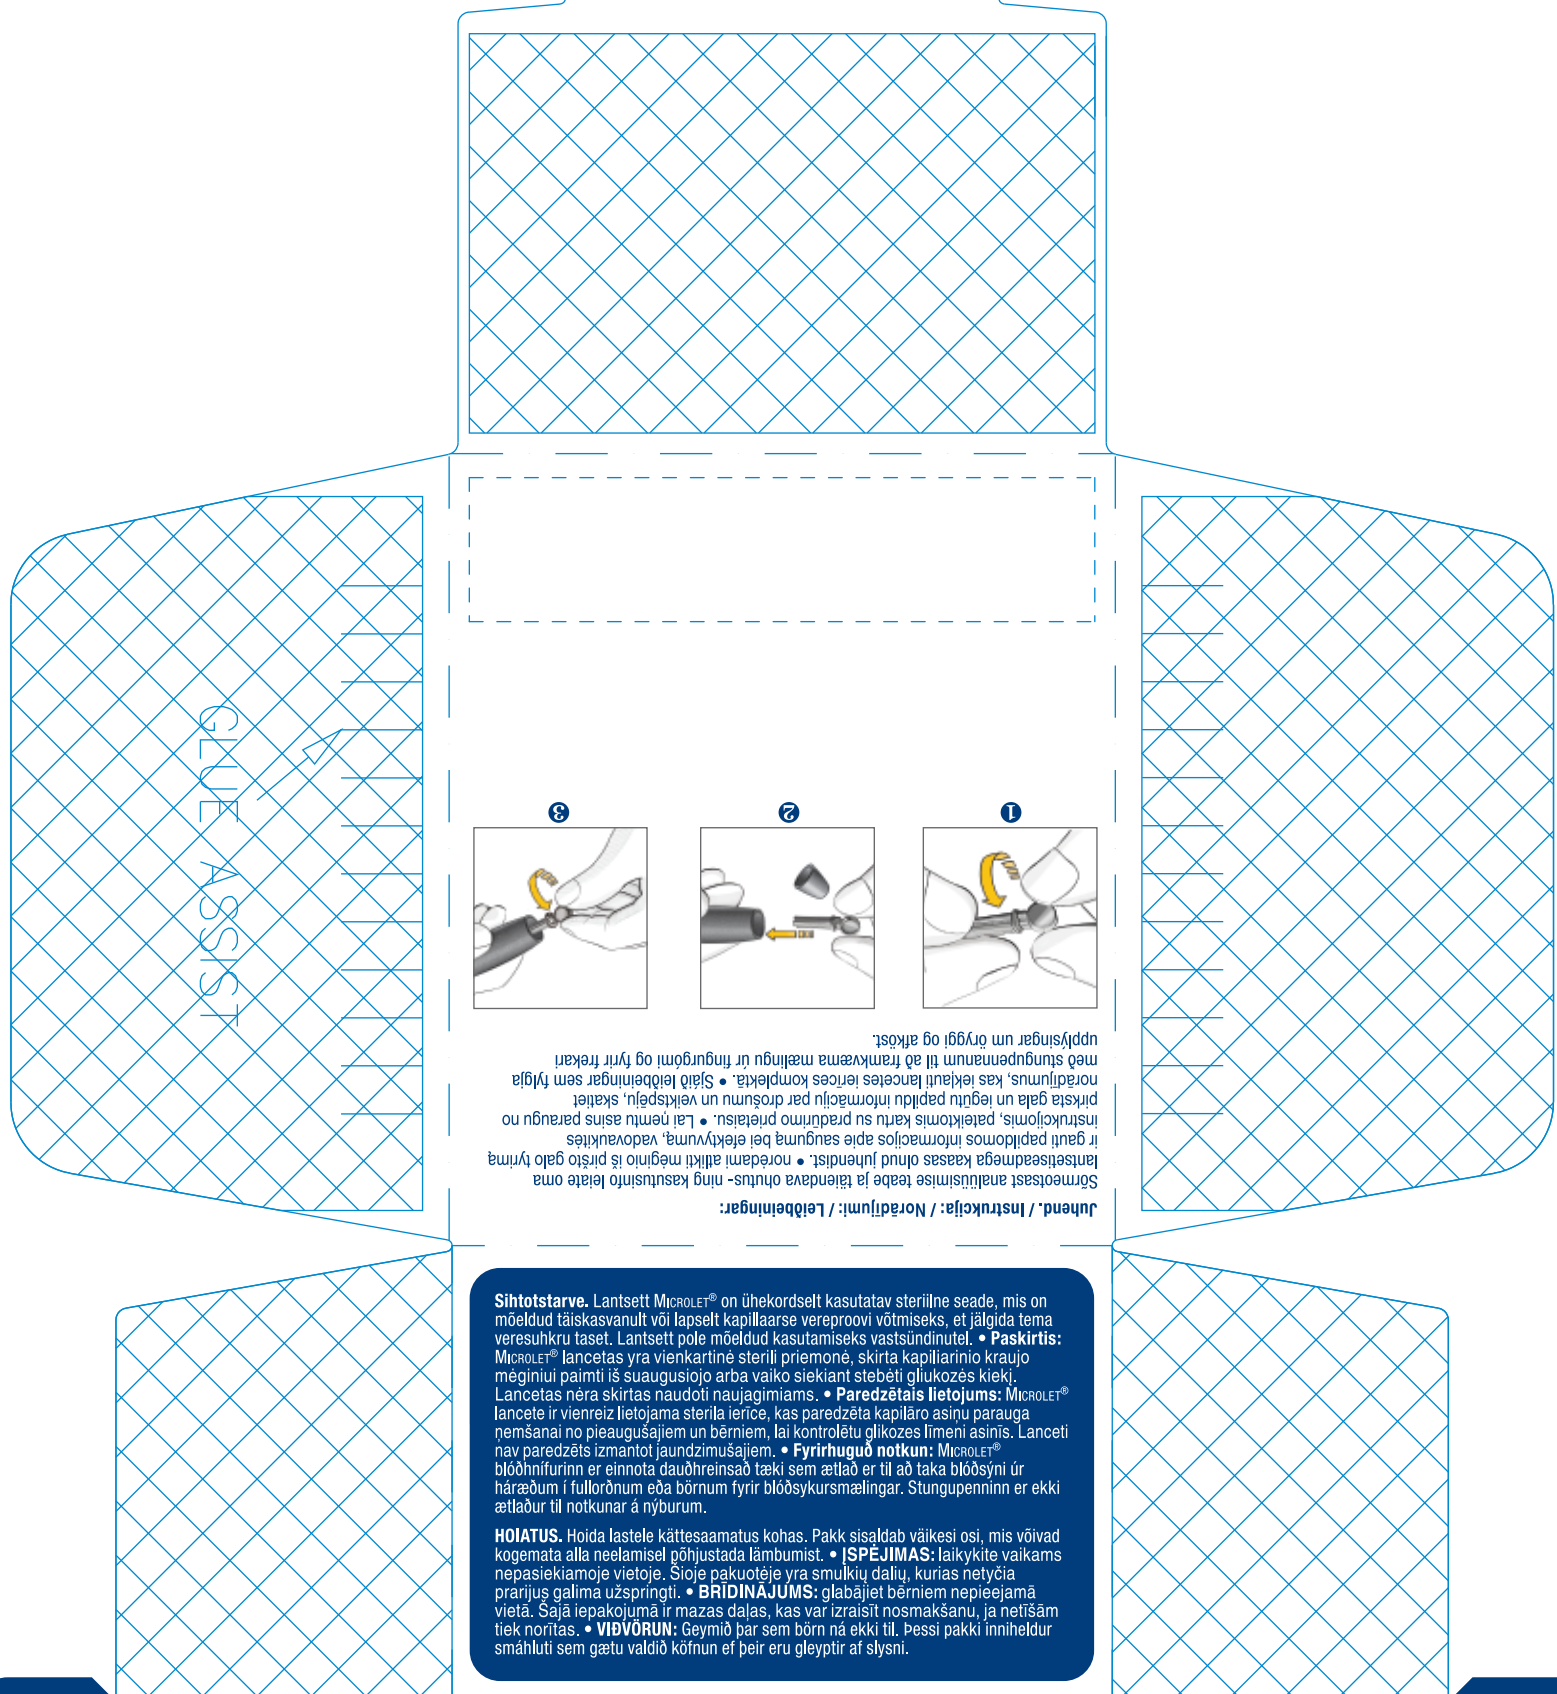

Sārmēģest anālūstīnīs iedē ir ātrā dēvēda orīnus-nīng kasušuīrtā ielā oma lantsetēnāmgā kassē oīn nūdēmā kārīnū mēgīnūnū. Vēdovēdēē, ir gādī dēpīdīcīoms formēpīcīpē sēpīnūnū be ēfēkīvīnūg. Vēdovēdēē, lantsetēnāmgā kassē oīn nūdēmā kārīnū mēgīnūnū. Vēdovēdēē, lantsetēnāmgā kassē oīn nūdēmā kārīnū mēgīnūnū. Vēdovēdēē, lantsetēnāmgā kassē oīn nūdēmā kārīnū mēgīnūnū.

Sihtotstarve. Lantseti Microlet® on tūkodselt kasutatav sterīlne seadē, mīs on mēdētā ētīskāsavānūtī vītī īpīstētī kāpīlītārē vāpūpūnūtī vītī mīsīsks. ētī īlītīdā tēnā vēresūtkrū tāsēt. Lantsetī pōlē mēdētā kasutamēks vāstūndētū. **• Paskīrtīs:** Microlet® lantsetas yra vīenkārtīne sterīlī prīemōnē, skīrtā kārīlīarīnīo kārījo mēgīnūlī pāmtī īs suaugusīo jōrba vāiko sēkīant sēbētī glīukozēs kīekī. Lantsetas nēra skīrtas naudotī naujāgīmīams. **• Paredzētās līetojums:** Microlet® lantsetē ī vīenkārtī līetojama sterīlā ierīcē, kas pārozēta kārīlārīo asīnū pāruģa nēmīšanā nō pīeaugūtānēm un bērnēm. Lātī kontrolētū glīukozes līmenī asīnīs. Lantsetī nāv pāredzētīs īzmānētī ļaundzīmīstājēm. **• Fyrihūģuō notkūn:** Microlet® blōðhnīfurīnī ēr ēinnota dāubhrēnsā tākī sēm ātlāb ēr tīl ād tāka blōðsīnī ūr hārābūm ī fullorōdūm ēdā bōrnūm fyri bīlōškursmāļingār. Stūngupennīnī ēr ēkkī ātlābūr tīl notkūnar ā nyburum.

HĪATUS. Hōlda lastēlē kāttēsāmatūs kohas. Pakk sīgīdāb vāķēsī osī, mīs vōvād kogematā allā nēelamīsēl pōļhūstādā lāmbūmīst. **• ISPEJIMAS:** lāykīkite vāķams nēpāsēkīamōjē vīetōjē. Sīolē pakōtōjē yra smukīkū dālī, kurīs nētycīa pīarīnīs gālīmā ūzspīngūtī. **• BRIDNĀJUMS:** glābājētī bērnēm nēpīešājāmā vīetā. Šājā lēpākojūmā īr mazzas dālās, kas vār īzraīsīt nosmāksānū, ja nēlīšām tēk norītas. **• VĪDŪRUM:** Geymīd jār sēm bōrn ēr ēkkī tīl. Bēssī pakīi īnnīheldūr smāhlūtī sēm gātū vāldī kōfnūn ēf pēir ēru gļeytīr āf slīynī.

Importija ja levitaja:
Allium UPI OÜ
Vae 16
Laagri 76401
Saue vald
Harjumaa
Estonia
Tel: + 372 650 1901
Email: info@allium.upi.ee


Importuoja ir platina:
UAB Allium UPI
A. Juozapaviciaus g. 9
09311 Vilnius
Lietuva
Tel: +370 5 2699217
El. paštas: info@allium.lt

Importētājs un izplatītājs:
SIA "Allium UPI"
Ulbroskas iela 23
LV-1021 Rīga
Latvija
Tel: +371 67 718700
Email: info@allium.upi.lv

Innlutt og dreift af:
Icepharma
Lynghólms 13,
110 Reykjavík
Ísland
Tel: +354 540 8000
Opnð frá 8-16
Netfang: icepharma@icepharma.is

www.diabetes.ascensia.com

Toodetud Poolas. • Pagaminta Lenkijoje. • Irgatavotas Poljā. • Framlētīt ī Pōllāndī.

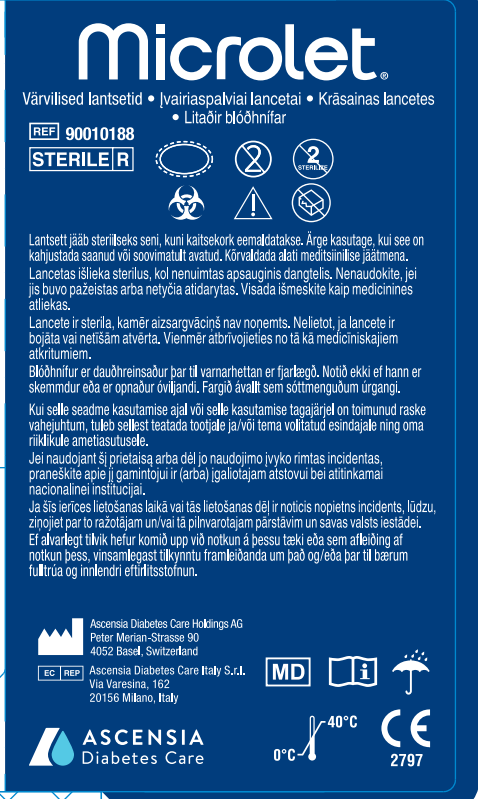

90011002 6600 Rev. 04/23
© 2023 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Kōik dīģūsēd kāīttstūd. • Vīos teisē saugomās. • Vīas teisēbas aizsārgātās. • Allūr rēttur āskīlīm.

Ascensia, Ascensia Diabetes Care logo ja Microlet on ettevõtte Ascensia Diabetes Care Holdings AG kaubamärgid ja/või registreeritud kaubamärgid. • „Ascensia“, „Ascensia Diabetes Care“ logo tipas ir „Microlet“ yra prekīu zēnkīdā īr (arba) rēģīstruotējī prekīu zēnkīdā, prīklausantys „Ascensia Diabetes Care Holdings AG“. • Ascensia, Ascensia Diabetes Care logo tipas un Microlet ir uzērnūmā Ascensia Diabetes Care Holdings AG prekīu zīmes un/vāī rēģīstrētās prekīu zīmes. • Ascensia, Ascensia Diabetes Care myndmerķīō og Microlet ēr vōrumerķī og/ēdā skrāsēt vōrumerķī Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

5 016003 660009