




Sihtotstarve. Lantsett MICROLET® on ühekordselt kasutatav steriilne seade, mis on mõeldud täiskasvanul või lapselt kapillaarse vereproovi võtmiseks, et jälgida tema veresuhkru taset. Lantsett pole mõeldud kasutamiseks vastsündinutel.

• **Paskirtsit.** MICROLET® lancetas yra vienkartinė sterili priemonė, skirta kapiliarinio kraujo mėginiiu paimti iš suaugusiojo arba vaiko siekiant stebėti gliukozės kiekį. Lancetas nėra skirtas naudoti naujagimiams.

• **Paredzētais lietojums:** MICROLET® lancete ir vienreiz lietojama sterila ierice, kas paredzēta kapilāro asiņu parauga ņemšanai no pieaugušajiem un bērniem, lai kontrolētu glikozes līmeni asinīs. Lanceti nav paredzēti izmantot jaundzimušajiem.

Juhend. / Instrukcija: / Norādījumi:
Sörmeotsast analiūsīmīse teabe ja tāiendava ohutus- ning kasutusinfo leiate oma lantsetiseadmega kaasas olind juhendist. • norēdami atlikti mėginio iš piršto galo tyrimā j gauti papildomos informācijas apie saugumą bei efektyvumą, žr. kartu su pradūrimo prietaisu pateiktā instrukcijā. • Lai ņemtu asins paraugu no pirksta gala un iegūtū papildu informāciju par drošumu un veikspēju, skatiet norādījumus, kas iekļauti lancetes ierices komplektā.

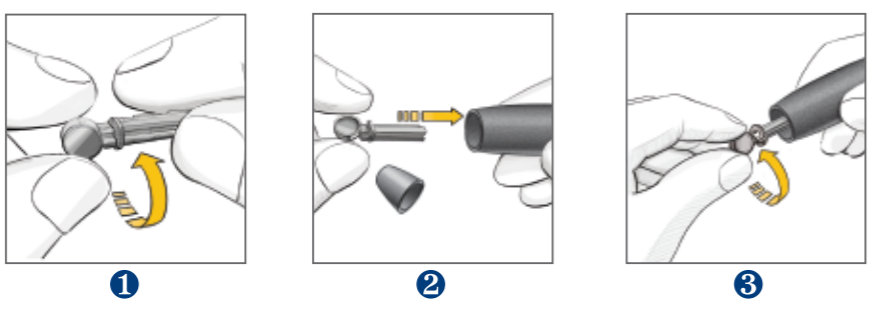

© 2022 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Kõik õigused kaitstud.
• Visas teisēs saugomos. • Visas tiesības aizsargātas.

Teavet patentide ja nendega seotud litsentside kohta vaadake: www.patents.ascensia.com.
• Informācija apie patentus ir susijusias licencijas pateikta www.patents.ascensia.com.
• Informāciju par patentiem un saistītajām licencijām skatiet vietnē www.patents.ascensia.com.

90010174 Rev. 04/22

Microlet.
Värvilised lantsetid • Ivainiaspalviai lancetai • Krāsainas lancetes

REF 90010187

STERILE

• Ārge kasutage, kui pakend on kahjustatud • Nenaudoti, jeigu pakuotē pāžeista • Nelietot, ja iepakojums ir bojāts

Lantsett jāb sterilīss seni, kuni kaitsekork eemaldātakse. Ārge kasutage, kui see on kahjustāda saanud vōi soovimātul atavud. Kōrvēlāda abāi meditsīnīlīse jātmena.

Lancetas īslīeka sterīlus, kol nenuimtas apsauginis dangtelis. Nenaudokite, ja jēlis buvo pāžeistas arba netyčia atidarytas. Visada išmeskite kaip medicīnīnes atliekas.

Lancete ir sterila, kamēr aizsargvācīns nav noņemts. Nelietojiet, ja iepakojums ir bojāts vai netīšām atvērts. Vienmēr atbrvojietes no tā kā medicīniskajiem atkritumiem.


Microlet.
Värvilised lantsetid • Ivainiaspalviai lancetai • Krāsainas lancetes

Lihne testimine
Paprstas ir neskausmingas tyrimas
Vienkārša, ērta pārbaude

200 (8x25)
Silikoonkattega lantsetid
Silikonu dengti lancetai
Ar silikonu pārklātas lancetes

ET • Kasutada koos seeria MICROLET® lantsetiseadmetega.
LT • Naudoti su „MICROLET®“ grupės pradūrimo prietaisais.
LV • Lietojiet kopā ar MICROLET® saimes lancetes ierīcēm.

Ascensia, Ascensia Diabetes Care logo ja Microlet on ettevõtte Ascensia Diabetes Care Holdings AG kaubamärgid ja/või registreeritud kaubamärgid.
• „Ascensia“, „Ascensia Diabetes Care“ logotipid ja „Microlet“ yra prekų ženklai ir (arba) registruojami prekų ženklai, priklausantys „Ascensia Diabetes Care Holdings AG“.
• Ascensia, Ascensia Diabetes Care logotipid ja Microlet ir užrašymai Ascensia Diabetes Care Holdings AG preču žymes un/vai registruotas preču žymes.

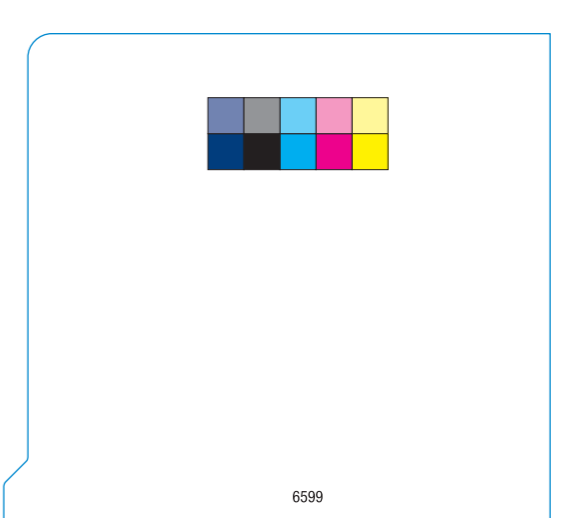

6599

Importija ja levitaja:
Allium UPI OÜ
Vae 16
Laagri 76401
Saue vald
Harjumaa
Estonia
Tel. + 372 650 1901
Email: info@allium.upi.ee

Importuoja ir platina:
UAB Allium UPI
A. Juozapaviciaus g. 9
09311 Vilnius
Lietuva
Tel.: +370 5 2699217
El. paštas: info@allium.lt

www.diabetes.ascensia.com
Toodetud Poolas. • Paganimta Lenkijoje. • Izgatavotas Polijā.
Kui šelle seadme kasutamīse ajal vōi šelle kasutamīse tagāiņēd on toimunud raske vahēritum, jūklā sakest ietādā kōvāte jāvā tēma vōlītādā dērdīdē jēng omā rādītulē empāsāsestē. • Ja naudojant šį prietaisą atpa dēl jō naudojimo tykvo mīdas indovatas, praneškite apie jō gamitovū ir (arba) jgalotajam atstovū bei atitinkamai nacionalinei institucijai. • Ja šis ierices lietotānes jākā va tās lietotānes dēl ir noticis nopētris incidents, lūdzū, zinojiet par to rādotajam un/vai lā pīlvarojam pārstāvū un sausa vāstē iestādē.

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4002 Basel, Switzerland

Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l.
Via Varesina, 162
20156 Milano, Italy

MD • Meditsīnīse adme
• Medicīnos priemone
• Medicīniska ierice

EC • Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l.
Via Varesina, 162
20156 Milano, Italy

0°C 10% 40°C 65%
Nāksuplirāng
Drogmā apģobojimas
Gāisa mitruma ierēbējoms

ASCENSIA
Diabetes Care

CE 2797